



# 中华人民共和国医药行业标准

YY 1040.2—2008/ISO 5356-2:2006

---

## 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第2部分:螺纹承重接头

Anaesthetic and respiratory equipment—Conical connectors—  
Part 2:Screw-threaded weight-bearing connectors

(ISO 5356-2:2006, IDT)

2008-10-17 发布

2010-06-01 实施

---



国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

YY 1040《麻醉和呼吸设备 圆锥接头》，由下列部分组成：

——第 1 部分：锥体和锥套；

——第 2 部分：螺纹承重接头。

本部分为 YY 1040 的第 2 部分。

本部分等同采用国际标准 ISO 5356-2:2006《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第 2 部分：螺纹承重接头》。

本部分与 ISO 5356-2:2006 相比较，主要差异如下：

——ISO 5356-2:2006 的引言转化为本标准的引言，删除了 ISO 5356-2:2006 的前言；

——ISO 5356-2:2006 中引用的 ISO 国际标准，有对应被转化为国家标准和行业标准，本部分以引用这些国家标准和行业标准作为规范使用；现无对应被采用为国家标准和行业标准，则以所引用的 ISO 国际标准作为规范使用。

本部分由全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：上海市医疗器械检测所。

本部分主要起草人：王伟、郁红漪。

## 引 言

尽管 YY 1040.1—2003 中描述的圆锥接头可用于轻型呼吸附件的连接,然而对于支持重型或易碎的附件,需要更加坚固的接头。这些接头的设计因素包括强度,简易,易于灭菌,易于用手连接和拆卸。这些接头还应该与符合 YY 1040.1 要求的接头相兼容,并且,尽管在使用之前检查系统是否正确安装是用户的责任,这些接头也应该尽量避免偶然错误连接的可能性。

YY 1040 的本部分中描述的螺纹承重接头可以用于呼吸系统中共同气体出口处的附件。

# 麻醉和呼吸设备 圆锥接头

## 第2部分:螺纹承重接头

### 1 范围

YY 1040 的本部分详细说明了用于吸入麻醉设备和呼吸机的螺纹承重圆锥接头的要求,这些接头用于装备重型附件。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 YY 1040 的本部分的引用而成为本部分标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 9145—2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(ISO 965-2:1998,MOD)

YY 1040.1—2003 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分:锥体和锥套(ISO 5356-1:1996,IDT)

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 YY 1040 的本部分。

#### 3.1

**吸入麻醉设备** *inhalation anaesthesia apparatus*

用于分配并输送麻醉气体及蒸汽到通气系统以输送给患者的设备。

注:根据 GB/T 4999—2003 中定义 2.1.1 改写。

#### 3.2

**通气附件** *breathing attachments*

组成或完善一个通气系统的组件。

注:根据 GB/T 4999—2003 中定义 4.1.6 改写。

#### 3.3

**通气系统** *breathing system*

在任何形式的通气期间,与患者的呼吸道相接的、用于连续或间歇传输气体的通路。

注1:实际上,通气系统通常延伸自:

- a) 混合气体的供气端口<sup>1)</sup>,例如麻醉机的共同气体出口。或
- b) 循环系统的新鲜气体输入口,如呼吸机、T型管等。或
- c) 手动人工呼吸器的新鲜气体输入口。

注2:通气系统通常延伸到混合气体从 APL 阀、T型管的开口端等到大气或气体净化系统的出口。

注3:连接到气体净化系统的专用气路不能看作是通气系统的一部分。

注4:根据 GB/T 4999—2003 中定义 4.1.1 改写。

### 4 设计


螺纹承重接头组件的尺寸见图 1。

1) 在一些情况下,特别是在呼吸机中,该端口可能在设备内部,不应与安装在其他地方如呼吸机外壳上的接口相混淆。

凹型组件上的管接螺母的轴向移动不超过 2 mm,以便当接头未拧紧时,凸型组件和凹型组件可被分开。

根据 GB/T 9145—2003,所有外螺纹必须为 M33×2-6g,所有内螺纹必须为 M33×2-6H。

单位为毫米

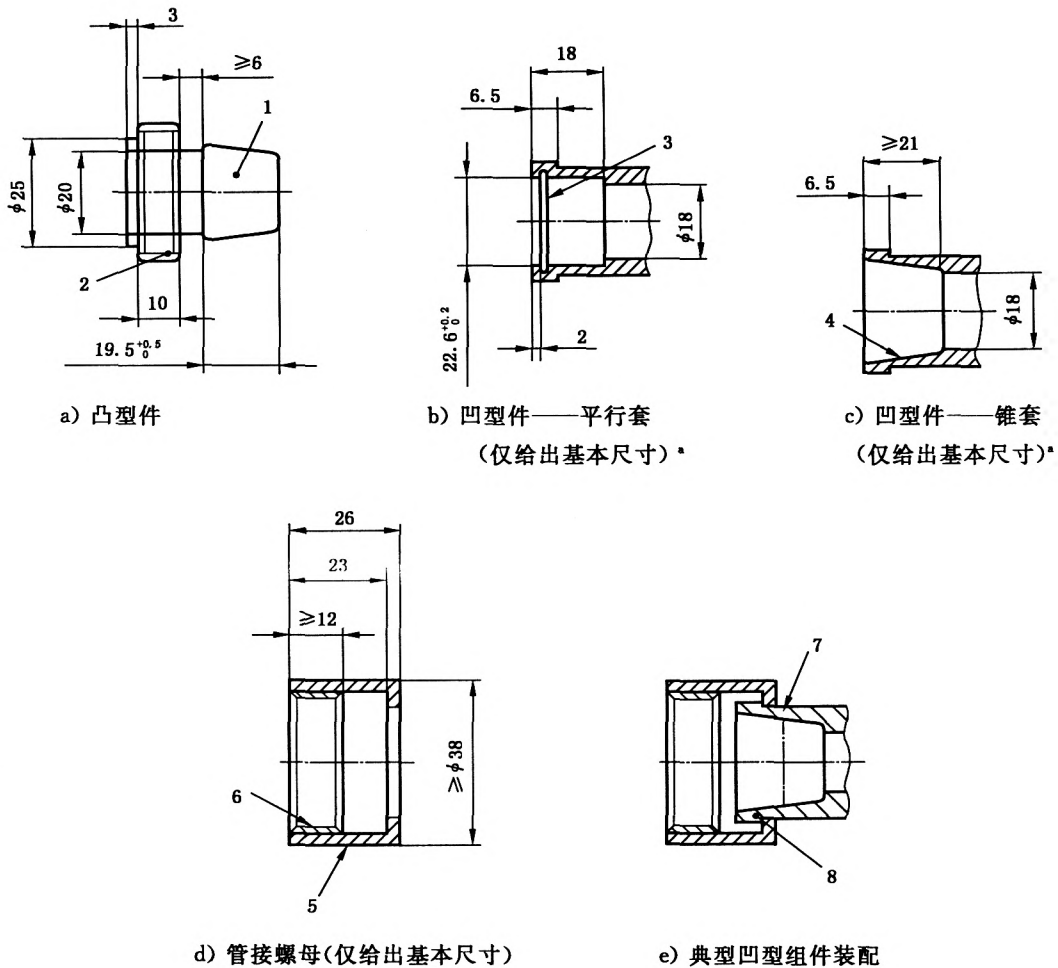

1——YY 1040.1—2003 中描述的 22 mm 外圆锥接头或 22 mm/15 mm 同轴接头;

2——外螺纹;

3——配内径 22.1、截面 1.6 的 O 型圈用的 O 型槽[推荐尺寸  $\phi 24.8 \times (2.3^{+0.2})$ ];

4——YY 1040.1—2003 中描述的 22 mm 内圆锥接头;

5——滚花;

6——内螺纹;

7——制动接线片、台肩或簧环的位置;

8——制动台肩<sup>b</sup>。

<sup>a</sup> 直径 18 mm,用于通气系统。

<sup>b</sup> 管接螺母可以通过一个簧环代替台肩来制动。

图 1 螺纹承重接头组件

参 考 文 献

- [1] GB/T 4999—2003 麻醉呼吸设备 术语(ISO 4135:2001, IDT).
  - [2] JB/T 7912—1999 商品紧固件的普通螺纹选用系列(eqv ISO 262:1973).
-

中华人民共和国医药  
行业标准  
麻醉和呼吸设备 圆锥接头  
第2部分:螺纹承重接头

YY 1040.2—2008/ISO 5356-2:2006

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*


开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字  
2008年12月第一版 2008年12月第一次印刷

\*

书号:155066·2-19290 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

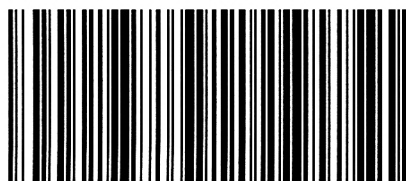

YY 1040.2-2008